

BM-S シリーズ 分析用電子天びん

設置マニュアル




BM-255DS / BM-125DS

取扱説明書はこちらをご覧ください


- 設置上の注意は取扱説明書の"計量前の注意(設置環境の配慮、計量準備及び注意事項)"を参照してください。
- 本製品は精密機器です。開梱時の取り扱いには注意してください。
- 付属品がそろっているかご確認ください。
- 梱包箱等は修理時の輸送等に必要となりますので、保管されることをお勧めします。

以下のように組み立ててください。

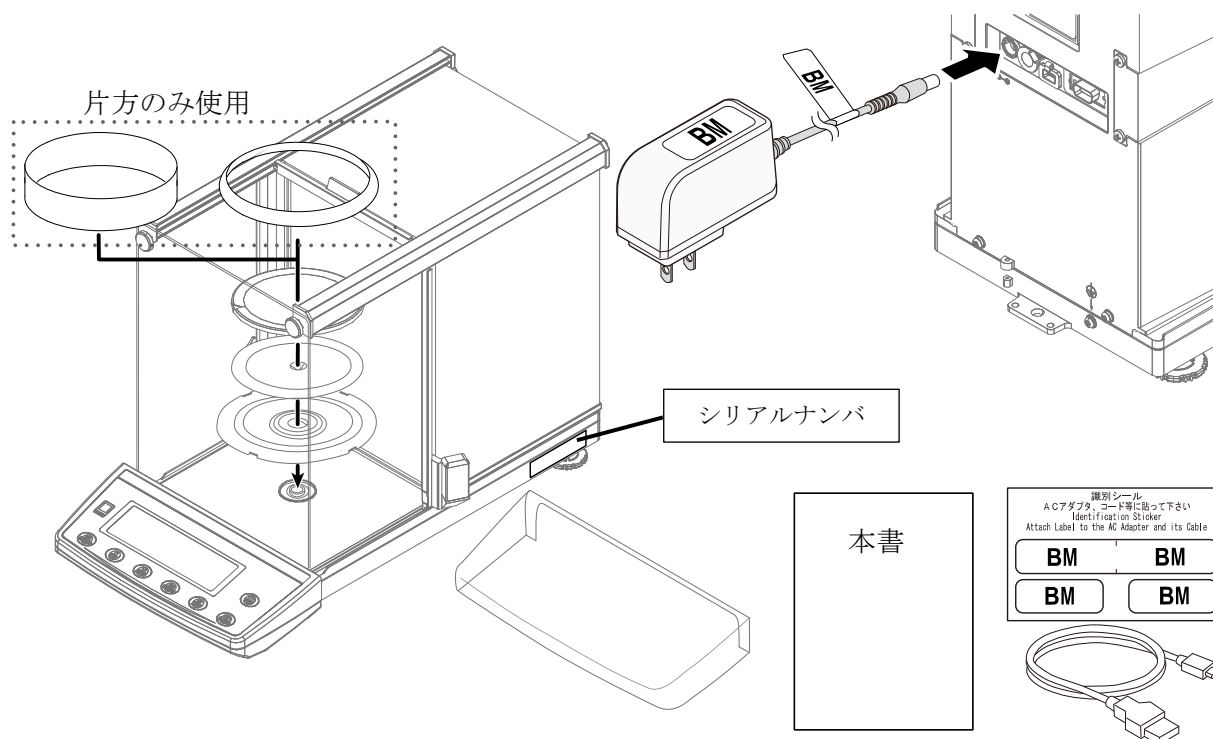

注意

- ダストプレートは、下図を参考に正しい向きに設置してください。


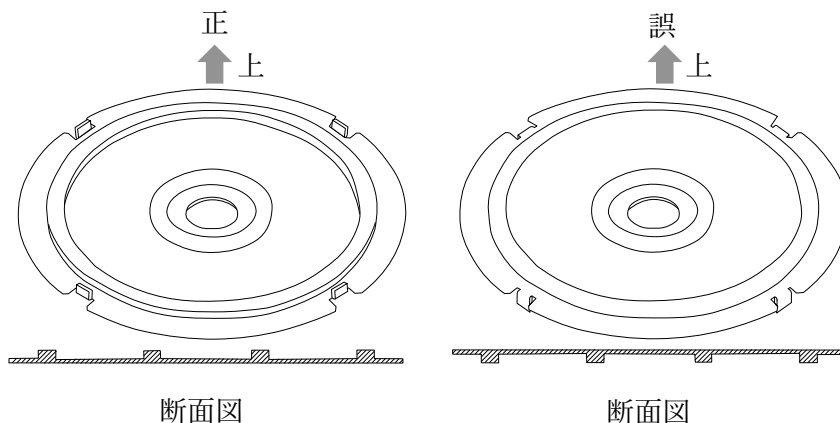


⚠ 注意

- 指定された専用 AC アダプタを使用してください。
- 塵埃の少ない部屋に設置してください。
- 天びん台は堅固なものを使用してください。
- エアコン等の風が直接当たらない場所に天びんを設置してください。
- 天びんは腐食性ガス、引火性ガスが漂うところに設置しないでください。
- 使用前には、AC アダプタを天びんに接続した状態で 1 時間以上通電してください。
- 天びんを設置した場所で、正しく計量できるよう必ず感度調整を行ってください。

水平器の調整方法

○ 水平器の円 ● 気泡

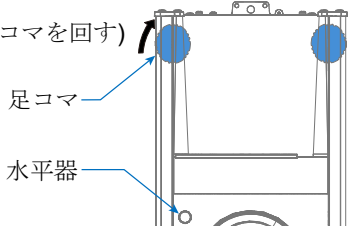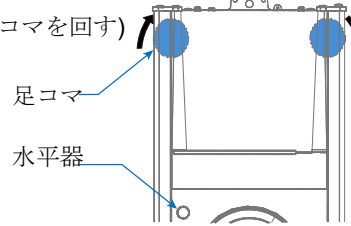水平器	手順	足コマの調整方法
 天びん本体の 右側が高く 傾いています。	①左右の傾斜の調整 足コマを回して高さを調整します。 (この例では右図のように左側を高く します。)	左側を高くする。 (矢印の方向に足コマを回す)  足コマ 水平器
 天びん本体の 前面が高く 傾いています。	②前後の傾斜の調整 足コマを回して高さを調整します。 (この例では右図のように背面を高く します。)	背面を高くする。 (矢印の方向に足コマを回す)  足コマ 水平器

仕様

	BM-255DS	BM-125DS
ひょう量	250 g	120 g
	101 g	51 g
最小表示	0.1 mg (0.0001 g)	0.1 mg (0.0001 g)
	0.01 mg (0.00001 g)	0.01 mg (0.00001 g)
繰返し性 (標準偏差)	0.1 mg (250 g)	0.1 mg (120 g)
	0.03 mg (100 g)	0.03 mg (50 g)
	0.02 mg (50 g)	
直線性	±0.2 mg	±0.2 mg
計量皿寸法	φ 90 mm	
本体質量	約 10 kg	
外形寸法	259(W) × 466(D) × 326(H) mm	
動作温度・湿度	5℃ ～ 40℃、85%RH 以下 (結露しないこと)	
電源 (AC アダプタ)	AC アダプタ規格名 : AX-TB248 入力 : AC100 ～ 240 V (+10%, -15%) 消費電力 : 約 30 VA (AC アダプタ含む)	
消費電流	DC12 V 約 0.3 A (AC アダプタ、オプション除く)	